Trousse neo Screw Remover

Une solution de rechange pour retirer des vis brisées

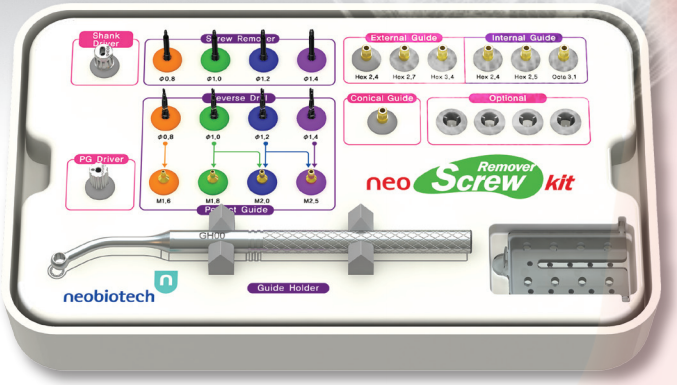

Simple, rapide et facile à utiliser

- Retire une vis brisée
- Fonctionne avec divers systèmes d'implants

HUBERMED

Trousse neo Screw Remover

Trousse d'instruments pour retirer une vis brisée de l'implant

Vis brisée

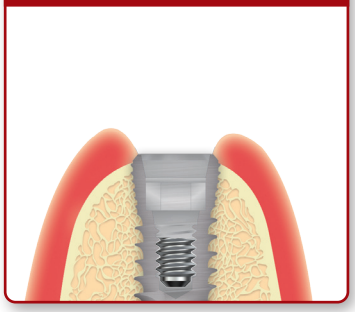

Mise en contact avec Perfect Guide

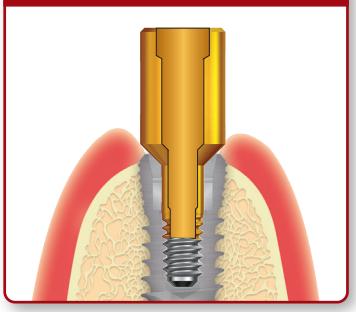

Inversion du forage

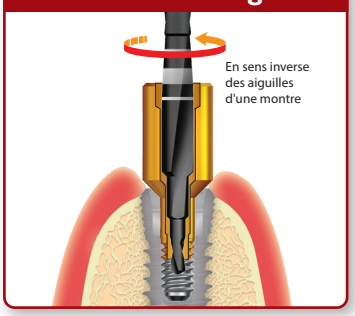

Vitesse : De 1 200 à 1 300 T/M

Retrait de la vis

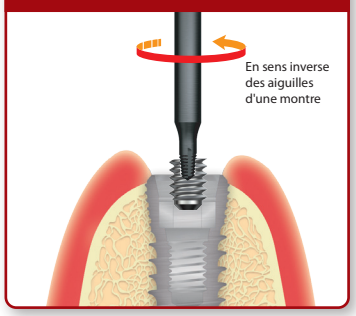

Vitesse : Inférieure à 80 T/M

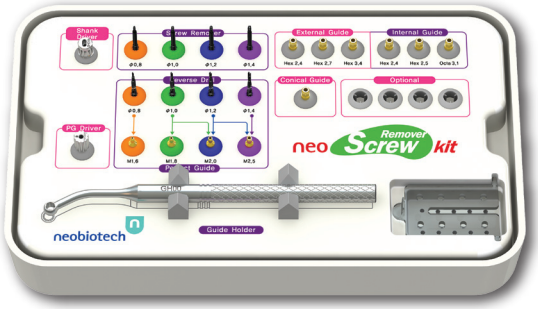

▶Contenu de la trousse Neo Screw Remover

Foret à mouvement inverse

Le foret à mouvement inverse sert à effectuer une marque de perforation dans la vis brisée où l'on installera le dispositif pour retirer la vis. La vitesse recommandée pour le foret est de 1 200 à 1 300 T/M.

Dispositif de retrait de la vis

La vis brisée est retirée au moyen d'une rotation inverse exercée par le dispositif pour retirer la vis, à une vitesse inférieure à 80 T/M.

Perfect Guide

Le Perfect Guide sert à obtenir un rendement optimal avec le foret à mouvement inverse. Il permet une meilleure fixation entre l'interface de la vise brisée et le foret.

Guide interne et externe

Le guide interne et externe permet de remplacer le Perfect Guide si ce dernier ne peut être utilisé ou si la vis brisée est située à plus de 2 mm à l'intérieur de la chambre femelle de l'implant.

Shank Driver

Le Shank Driver est utilisé pour ajuster le dispositif de retrait de la vis à des fins d'application manuelle ou au besoin utilisé conjointement avec la clé dynamométrique ou la clé à cliquet.



Guide conique

Le guide conique permet de remplacer le Perfect Guide si ce dernier ne peut être utilisé lorsque la vis brisée est située à plus de 2 mm à l'intérieur de la chambre femelle de l'implant.

PG Driver

Le PG Driver est utilisé pour se raccorder au Perfect Guide.



Porte-guide

Le porte-guide est utilisé pour offrir un meilleur contrôle et une meilleure manipulation de tous les guides, à l'exception du Perfect Guide.

Note : Ce guide est destiné uniquement à des fins éducatives.
Pour tout renseignement supplémentaire concernant ce produit, veuillez consulter le mode d'emploi.

Pour en savoir davantage sur ce produit, visitez notre site www.hubermed.com.
Pour parler à un représentant commercial, composez le 1 (888) 789.9928

Renseignements pour commander des produits

Numéro de catalogue	Description
SRKIT	Trousse Screw Remover

HUBERMED est le distributeur exclusif au Canada de la trousse Neobiotech NEO SR (Trousse Neo Screw Remover)

© 2011 ***HUBERMED inc.*** Tous droits réservés.
La trousse Neo Screw Remover est fabriquée par Neobiotech Co. Ltd. et distribuée au Canada par ***HUBERMED inc.***

HUBERMED inc.
9900, boul. Cavendish, suite 400,
St-Laurent, Qc., Canada H4M 2V2
Tél.: 1 (888) 789.9928
Skype: hubermed • Courriel: info@hubermed.com
www.hubermed.com